BELLAVITA

Lietošanas instrukcija

Satura rādītājs

Priekšvārds 3
Atbilstības deklarācija 3
Kalpošanas laiks 3
Identifikācijas plāksne 3
Atkārtota lietošana 3
Garantija 3
Preces sastāvdaļas 4
Preces apraksts 5
Norāde 5
Jūsu drošībai 5
Svarīgi drošības noteikumi 6
Elektromagnētiskā saderība (EMC) 6
Uzstādīšana un lietošana 6
Sākotnējā uzstādīšana vannā 7
Vannas pacēlāja piestiprināšana pie vannas pamatnes 7
Pārvalku uzlikšana/noņemšana 9
Galvas balsta uzstādīšana (pēc izvēles) 9
Manuālā vadība 9
Darbība vannošanās laikā 10
Pacēlāja izņemšana no vannas 11
Uzturēšana un apkope 12
Tīrīšana 12
Pārvalku kopšana 12
Vannas pacēlāja pārsega jaunu spilvenu aizbāžņu montāža. 12
Uzturēšana un apkope 12
Transportēšana/ mobilā lietošana 13
Tehniskie dati 14
Lietošanas vides nosacījumi 14
Vides nosacījumi transportēšanai un uzglabāšanai 14
Utilizēšana 14

Priekšvārds

Paldies, ka izvēlējāties Drive DeVilbiss preci.

Jums nenāksies vilties šīs preces izskatā, funkcionalitātē un kvalitātē.

Pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tajā ir ietverta svarīga drošības informācija un vērtīgi padomi pareizai lietošanai un kopšanai. Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, sazinieties ar savu Drive DeVilbiss specializēto izplatītāju, kurš piegādāja Jums šo preci.

Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta visa svarīgā informācija par preces pielāgošanu un lietošanu. Jaunākā lietošanas instrukcija ir pieejama PDF formātā tiešsaistē vai arī to var pieprasīt klientu apkalpošanas dienestā.

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem var tikt parādīti palielināti formāti. Neredzīgos pacientus instruē viņu pavadonis. Remontam, kā arī dažiem pielāgojumiem ir nepieciešama īpaša tehniskā apmācība, un tāpēc tie jāveic medicīnas preču izplatītājam.

Atbilstības deklarācija

Aprakstītajam produktam DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG apstiprina atbilstību medicīnas ierīču regulai (ES) 2017/745.

Kalpošanas laiks

Mūsu uzņēmums šai precei paredz piecu gadu kalpošanas laiku, ja vien prece tiek lietota atbilstoši paredzētajam nolūkam un tiek ievērotas visas uzturēšanas un apkopes prasības.

Šis kalpošanas laiks var tikt ievērojami pagarināts, ja izstrādājumam tiek nodrošināta rūpīga apiešanās, tas tiek atbilstoši remontēts, apkopts un lietots, un tam nav tehnisku ierobežojumu, saistībā ar zinātnes un tehnoloģiju turpmāko attīstību.

Tomēr ekstrēmas un nepareizas lietošanas rezultātā kalpošanas laiks var ievērojami samazināties. Mūsu uzņēmuma noteiktais kalpošanas laiks nesniedz nekādu papildu garantiju.

Identifikācijas plāksne

1. Artikula numurs | 2. Izstrādājuma nosaukums | 3. Ražotājs | 4. Sērijas numurs | 5. UDI kods | 6. Maks. slodze | 7. Izpildiet lietošanas instrukcijas | 8. Medicīnas ierīce | 9. Ražošanas datums (gads-mēnesis)

Atkārtota lietošana

Šo produktu var izmantot atkārtoti. Lūdzu ņemt vērā, ka visi tehniskie dokumenti, kas nepieciešami drošai lietošanai, ir jāiesniedz arī jaunajam lietotājam.

Šī prece ir jāpārbauda specializētam izplatītājam, tā ir jāiztīra un jāatjauno optimālā stāvoklī.

Sagatavošanas laikā vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus; tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

Piederumus var iegādāties pie specializētā izplatītāja vai **www.drivedevilbiss.de**.

Garantija

Uzņēmums Drive Medical piešķir šim produktam 5 gadu garantiju, kā arī 2 gadu garantiju akumulatoram.

Uz detaļām, kuras ir pakļautas nodilumam, parastajā garantijas perioda laikā garantija neattiecas, ja vien detaļām nav nepieciešams remonts vai nomaiņa, kas radies nepārprotamas, tiešas ražošanas vai materiāla kļūdas dēļ.

Mēs paturam tiesības uz kļūdām un izmaiņām, pamatojoties uz tehniskiem uzlabojumiem un konstrukcijas izmaiņām.

GARANTIJAS IZSLĒGŠANA

Nodilumam pakļautās daļas ir (cita starpā): pārvalki un piesūcekņi pie pacēlāja pamatnes

Preces sastāvdaļas

BELLAVITA

1. Atzveltne
2. Sēdekļa virsma
3. Sānu atloki
4. Šķērveida formas pacelšanas mehānisms
5. Pamatplāksne
6. Piesūcekņi pie pacēlāja pamatnes
7. Bloķēšanas svira
8. Robainais zobrats
9. Manuālā vadība

Preces apraksts

Paldies, ka izvēlējāties Drive Medical produktu. Šī izturīgā augstas kvalitātes prece turpmāk atvieglos iekāpšanu vannā un izkāpšanu no tās.

Vannas pacēlājs Bellavita atbilst spēkā esošajiem standartiem DIN EN ISO 10535: 2006 un DIN EN 60601-1:1996.

Bellavita vannas pacēlājs galvenokārt sastāv no augstas kvalitātes, otrreiz pārstrādājamas plastmasas ar vieglu konstrukciju. Rezultātā to var viegli transportēt un novietot, un tas ir piemērots lietošanai mājās, kā arī pansionātā vai ceļojuma laikā.

Manuālās vadības ierīce satur litija jonu akumulatoru.

Peldošā manuālā vadība ļauj ērti pacelt un nolaist pacēlāju parastā sēdus stāvoklī. Ir iespējams arī pārvietot pacēlāju starpstāvokļos.

Piedziņas motoram un vadības elektronikai ir ūdensnecaurlaidīgs korpuss. Tādējādi pacēlāju var izmantot arī mazgāšanās laikā vannā.

Izturīgais regulējamā augstuma rāmis ļauj pacelt un nolaist augstumā no 6,5 līdz 48 cm. Nospiežot up/down (uz augšu/uz leju) pogas, pacelšanas stienis paceļ/nolaiž sēdekļa virsmu.

Noņemamais jaudas agregāts, kuru var nolocīt uz priekšu un kuram ir integrēta atzveltne, ar klikšķi nofiksējas vietā sēdekļa virsmā un automātiski nobloķējas, kad tiek pacelts. Tas novērš nejaušu atzveltnes nolocīšanu.

Integrētās enerģijas kontroles rezultātā pacēlājs nolaižas tikai tad, ja ir pietiekami daudz enerģijas, lai to pilnībā paceltu.

Pie vidējā lietošanas biežuma (vienu reizi dienā) ieteicams preci nomainīt pēc 5 gadiem (atkarībā no preces kopējā stāvokļa).

Norāde

Vannas palīglīdzekļi ir produkti, kas ļauj lietotājam patstāvīgi veikt ikdienas ķermeņa kopšanu. Tie pilnībā vai daļēji kompensē ierobežotas vai neesošas ķermeņa funkcijas. Atbilstošu palīglīdzekļu izmantošanas mērķis ir ļaut slimniekiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām higiēnas jomā būt pēc iespējas neatkarīgākiem no ārējas palīdzības.

Vannas pacēlājs
Vannas pacēlāji tiek izmantoti cilvēka nolaišanai no vannas malas augstuma uz vannas pamatni un otrādi. Pacēlājs ir piemērots lietotājiem, kuriem ir būtiski augšējo un/vai apakšējo ekstremitāšu funkcionālie ierobežojumi, kuru dēļ nav iespējams patstāvīgi iekāpt vannā un izkāpt no tās vai apsēsties/piecelties, un kuriem pacēlāja izmantošana galvenokārt ļauj patstāvīgi nomazgāties vannā.

Jūsu drošībai

Informācija, kas jāievēro!
Droša mazgāšanās, izmantojot vannas pacēlāju iespējama tikai tad, ja rūpīgi izlasāt lietošanas instrukciju un rūpīgi sekojat tajā ietvertajai informācijai!

Svarīga informācija
• Vannas pacēlāju nedrīkst izmantot kā kāpnes, ierīci, kas atvieglo iekāpšanu un izkāpšanu no vannas, palīglīdzekli iekāpšanai vai izkāpšanai, balstu, pacelšanas platformu vai tamlīdzīgi. To drīkst izmantot vienīgi cilvēku mazgāšanai vannā.

• Sargāt bērnus un dzīvniekus no piekļuves vannas pacēlājam.

• Nepareizas darbības vai bojājumu gadījumā, lūdzam nekavējoties sazināties ar izplatītāju. Neveiciet nekādas neatļautas izmaiņas vai pārveidošanu. Remontu drīkst veikt tikai autorizētās darbnīcās vai pats ražotājs. Ja tas netiek ievērots, garantijas prasības nav spēkā.

• Celšanas stieni drīkst izvilkt tikai tad, kad atzveltne ir nolaista!

• Bellavita vannas pacēlājam nav atļauts izmantot augstuma adapterus.

• Neuzglabājiet šo preci tiešā siltuma avotu tuvumā.

Lūdzu, saglabājiet šo lietošanas instrukciju!

• Ja vannas pacēlājs tiek pārvadāts, manuālā vadība iepriekš ir jāatvieno no elektrotīkla.

• Ja pacēlājs ilgu laiku ir bijis pakļauts zemas temperatūras iedarbībai (piemēram, ilgstoša glabāšana transportlīdzeklī ziemā), pirms lietošanas tas jāsasilda līdz istabas temperatūrai, lai izvairītos no bojājumiem.

• Lietojot vannas eļļas vai vannas sāli, ievērojiet ieteicamo devu. Vannas piedevas var pasliktināt šķērveida pacelšanas mehānisma slīdēšanu.

• Vannas pacēlāja tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur etiķi.

Informācija par akumulatoru, barošanas bloku un manuālo vadību:

• Izmantojiet manuālo vadību tikai vannas pacēlāja darbināšanai.

• Vannas pacēlāju drīkst darbināt tikai ar oriģinālo Drive Medical manuālo vadību.

• Nekad nemetiet manuālās vadības ierīci ugunī un neuzglabājiet manuālo vadību uguns vai intensīva siltuma avotu tuvumā.

• Neatveriet manuālās vadības ierīci. Manuālās vadības ierīces atvēršana anulē jebkādu garantiju.

• Manuālās vadības ierīces akumulatora uzlādēšanai izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto barošanas bloku.

• Ja manuālās vadības ierīces korpuss ir bojāts, to vairs nevajadzētu lietot.

• Jūsu drošībai barošanas bloku drīkst izmantot tikai ārpus vannas istabas sausās vietās. Barošanas bloku drīkst izmantot tikai komplektā esošās manuālās vadības ierīces uzlādēšanai.

• Akumulators jāuzlādē pirms pirmās lietošanas reizes un pēc katras vannas pacēlāja lietošanas reizes. Ja ir ilgāki periodi, kad vannas pacēlājs netiek izmantots, akumulators ir jāuzlādē ik pēc 3 mēnešiem, lai pagarinātu tā kalpošanas laiku.

• Neievietojiet nekādus strāvu vadošus priekšmetus (piemēram, adāmadatas, metāla saspraudes utt.) manuālās vadības ligzdā.

• Pirms barošanas bloka tīrīšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

• Tīriet barošanas bloku tikai ar sausu drānu.

• Vannas pacēlājam, barošanas blokam un akumulatoram ir izturīga konstrukcija, tomēr tos nedrīkst nomest. Ja ir ārēji redzami un/vai dzirdami bojājumi, vannas pacēlāju nevajadzētu izmantot. Šādā gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Mēs iesakām šīs lietošanas instrukcijas beigās ievadīt izplatītāja adresi!

• Lai iegūtu plašāku informāciju, tehniskos datus un adreses, lūdzu, izlasiet visu lietošanas instrukciju.

• Nepareizas darbības gadījumā vispirms skatiet šīs lietošanas instrukcijas pielikuma sadaļu “Traucējumu meklēšana”. Noteikti ievērojiet tur sniegto informāciju un norādījumus. Savas drošības labad neizmantojiet vannas pacēlāju, kamēr darbības traucējumi nav novērsti.

Svarīgi drošības noteikumi

• Vienmēr sēdiet pacēlāja vidū, ar muguru pret atzveltni, nedaudz izstiepiet kājas un novietojiet brīvo roku vai nu uz vannas malas, vai klēpī. Izmantojiet otru roku, lai vadītu pacēlāju uz leju vai uz augšu.

• Pacelšanas vai nolaišanas laikā nelieciet rokas starp vannas malu un pacēlāju vai zem sēdekļa virsmas, jo šādi rīkojoties, varat gūt savainojumus.

• Personas ar nopietniem fiziskiem vai garīgiem traucējumiem nekad nedrīkst atstāt vannā bez uzraudzības. Mazgājieties patstāvīgi tikai tad, ja jūsu veselības stāvoklis to atļauj. Pretējā gadījumā mazgājieties tikai palīga uzraudzībā.

• Pirms vannas pacēlāja izmantošanas veiciet pārbaudes darbināšanu (pārvietojiet to uz augšu, uz leju, pieturiet, kā arī pārbaudiet ARKĀRTAS APTURĒŠANAS funkciju).

• Bojājuma gadījumā neturpiniet izmantot vannas pacēlāju; tā vietā veiciet pacēlāja remontu pie izplatītāja.

• Neņemiet līdzi vannā nekādus priekšmetus (piemēram, birstes utt.)!

Elektromagnētiskā saderība (EMC)

Piezīme:
Šis izstrādājums atbilst aizsardzības prasībām, kas uzskaitītas Padomes direktīvā par dalībvalstu likumu pielāgošanu elektromagnētiskās saderības jomā (EMC, IEC 60601-1-2) (89/336/EEC).

Tomēr noteiktos apstākļos nevar pilnībā izslēgt elektrisko ierīču savstarpējus traucējumus, jo īpaši, ja tiek izmantoti mobilie tālruņi. Vannas pacēlāja tuvumā nedarbiniet nekādas dzīvības saglabāšanas, dzīvību uzturošas ierīces vai ierīces, kas darbības traucējumu gadījumā var radīt risku lietotājiem.

Noteiktos apstākļos tie var darboties nepareizi vai traucēt pareizu vannas pacēlāja darbību. Ja pamanāt vannas pacēlāja vai tuvumā darbināto elektrisko ierīču darbības traucējumus vai neparastu darbību, pārtrauciet vannas pacēlāja lietošanu un sazinieties ar izplatītāju.

Uzstādīšana un lietošana

Izpakošana

Pie preces piegādes iepakojuma kārbā ir jābūt šādām sastāvdaļām:

• Piedziņas bloks ar integrētu atzveltni un manuālās vadības ierīci

• Sēdekļa bloks ar sānu atlokiem

• Barošanas bloks

• Lietošanas instrukcija

• 4 x piesūcekņi, diametrs 75 mm, montāžai uz pamatplāksnes

Ja kāda no uzskaitītajām detaļām trūkst vai ir bojāta, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju.

Kārbu var atkārtoti izmantot transportēšanai un vannas pacēlāja uzglabāšanai.

Pirms pirmās lietošanas akumulators ir jāuzlādē. Lai to izdarītu, ir jāievēro norādījumi sadaļā “Akumulatora uzlāde”.

Sākotnējā uzstādīšana vannā

1. Vispirms pamatplāksnes apakšā ievietojiet aizmugurējos piesūcekņus ar kustīgajiem spraudņiem **(1. fotoattēls)**.

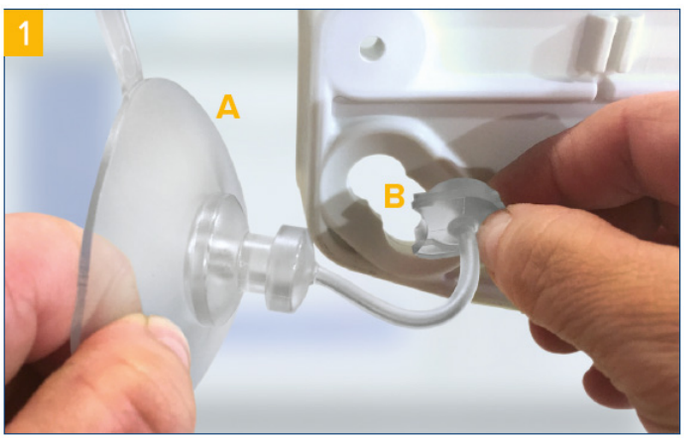

A) Sēnes formas galva | **B)** Spraudnis

2. Izspiediet piesūcekņa sēnes formas galvu caur mazo atveri, viegli pagriežot to galīgajā pozīcijā. Pārliecinieties, lai ventilācijas cipas ir vērstas uz aizmuguri **(2. fotoattēls)**.

C) Ventilācijas cilpa

3. Iespiediet spraudni no augšas plāksnes atverē, līdz tas ir vienā līmenī **(3. fotoattēls)**.

4. Tādā pašā veidā ievietojiet priekšējo piesūcekni, tomēr šajā gadījumā papildus iespiediet ventilācijas cilpu pamatplāksnes padziļinājumos. Rezultātā priekšējie piesūcekņi noņemšanas laikā tiek automātiski atgaisoti **(4. fotoattēls)**.

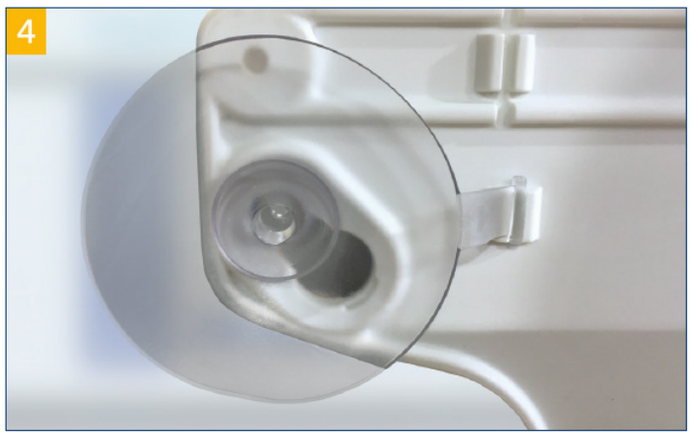

Nostipriniet vannas pacēlāju pie vannas pamatnes

Informācija, kas jāievēro:

Piesūcekņi nostiprina vannas pacēlāju pie vannas pamatnes. Tādēļ piesūcekņiem vannas pacēlāja apakšā ir jābūt tīriem un sausiem, kad vannas pacēlājs tiek izmantots vannā, kas arī ir tīra un sausa. Ieteicams regulāri tīrīt piesūcekņus un vannu ar tirdzniecībā pieejamiem tīrīšanas līdzekļiem, lai nodrošinātu labāko iespējamo saķeri.

1. Pārliecinieties, vai tukšās vannas pamatne ir tīra un vannā nav neslīdošā paklājiņa.

2. Tukšā vannā novietojiet sēdekļa bloku ar piesūcekņiem, kas uzstādīti uz pamatnes plāksnes tā, lai aizmugurējie piesūcekņi atrastos slīpuma sākumā pie vannas aizmugurējās sienas.

3. Pēc tam ievietojiet piedziņas bloku ar integrētu atzveltni, kā parādīts **5. - 6. fotoattēlā**, ar bloķēšanas fiksatoriem sēdekļa gultņu blokos.

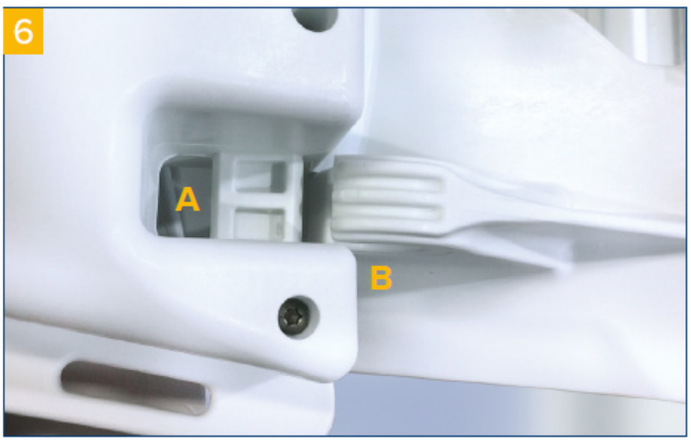

A) Gultņu bloks | **B)** Bloķēšanas fiksators

Svarīgi! Jānodrošina, lai gultņu blokos būtu ievietoti abi bloķēšanas fiksatori.

4. Tagad ar otru roku pagrieziet atzveltni uz augšu pie rokturiem **(7.-8. fotoattēls)** un pastumiet to līdz galam atpakaļ, līdz piedziņas bloks balstās uz pamatplāksnes atdures.

C) Rokturis

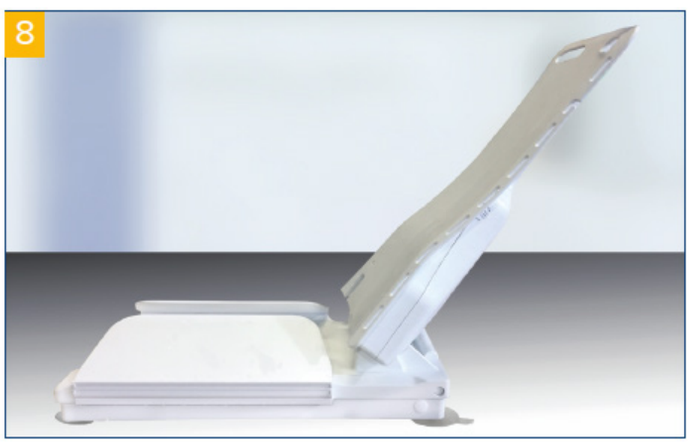

Piezīme: Ja vannas siena atzveltnes pusē ir vertikāla un tādējādi atzveltne var atsisties pret vannas sienu, pacēlājs ir jāuzstāda ārpus vannas un jānovieto visaugstākajā pozīcijā, pirms to ievieto vannā. Lietojot to vannošanās laikā, noteiktos apstākļos vairs nav iespējams noliekt atzveltni, jo starp atzveltni un vannas sienu nav pietiekami daudz vietas.

5. Pārliecinieties, vai pacelšanas stienis ir pareizi novietots slīpnē.

Pārliecinieties, vai sarkanā bloķēšanas svira ir pareizā stāvoklī (9.-10. Fotoattēls).

Pareizi

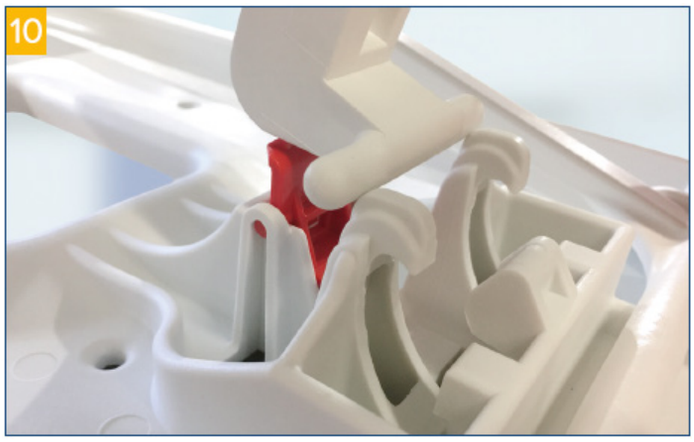

Nepareizi

6. Ievietojiet manuālās vadības ierīci vannas pacēlājā. Lai to izdarītu, uzmauciet ligzdu uz pacēlāja manuālās vadības spirālveida vada, līdz tā manāmi nofiksējas vietā un sarkanais gredzens uz pacēlāja vairs nav redzams. Pēc tam vannas pacēlājs ir gatavs lietošanai **(11. fotoattēls)**.

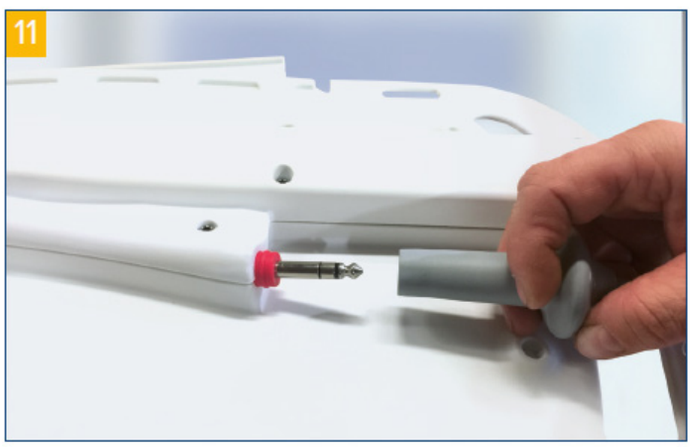

Pārvalku uzvilkšana/noņemšana

Pārvalkus var viegli uzvilkt un noņemt.

Lai nostiprinātu pārvalku, vienkārši novietojiet pārvalku pareizajā pozīcijā uz atzveltnes plāksnes vai sēdekļa virsmas un līdz galam nospiediet piestiprināšanas pogas attiecīgajos atzveltnes plāksnes vai sēdekļa virsmas un sānu atloku caurumos **(12.- 15. fotoattēls)**.

Sēdekļa pārvalks

Atzveltnes pārvalks

Sēdekļa pārvalks

Atzveltnes pārvalks

Vannas pacēlāju var izmantot arī bez sēdekļa pārvalka.

Lai noņemtu pārvalkus, ar diviem pirkstiem izvelciet apakšējiem caurumiem abas stiprinājuma pogas.

Galvas balsta uzstādīšana (pēc izvēles)

Ievietojiet abus galvas balsta stieņus atverēs piedziņas bloka augšpusē. Vēlamo augstumu var vienmēr regulēt **(16.-18. fotoattēls)**.

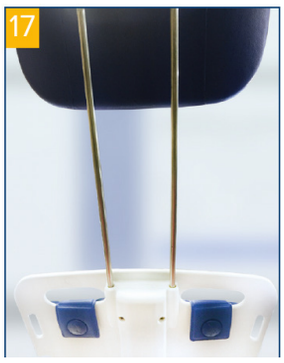

Manuālās vadības pults

Pilnībā uzlādēta akumulatora jauda ir pietiekama maksimāli 6 mazgāšanās reizēm, atkarībā no lietotāja svara. Mazgāšanās laikā manuālās vadības pults indikators deg zaļā krāsā.

Kad akumulatora uzlādes līmenis nokrītas līdz noteiktai vērtībai, gaismas krāsa mainās uz dzeltenu un lēnām mirgo. Tas parāda, ka var nodrošināt vēl 1 mazgāšanās reizi. Pēc tam akumulators jāuzlādē saskaņā ar instrukciju.

Ja tiek izmantota arī akumulatora dzeltenā fāze, gaismas krāsa var mainīties no dzeltenas uz sarkanu un ātri mirgot. Ja tā notiek, pacēlājs virzīsies tikai uz augšu un tādējādi nodrošinās drošu pacelšanu.

Tagad saskaņā ar instrukciju akumulators ir nekavējoties jāuzlādē, izmantojot komplektācijā iekļauto barošanas bloku.

ZAĻĀ gaisma: pacēlājs ir gatavs lietošanai.

DZELTENĀ gaisma: pacēlājs daļēji darbojas ar pietiekamu jaudu tikai vēl 1 mazgāšanās reizei. Akumulators ir jāuzlādē.

SARKANĀ gaisma: pacēlājs vairs nav gatavs lietošanai, var pārvietoties tikai uz augšu. Akumulators ir nekavējoties jāuzlādē.

ĀRKĀRTAS APTURĒŠANAS poga (sarkana): Ja kādreiz esat nonācis ārkārtas situācijā, kad ir nepieciešams apturēt vannas pacēlāju, nospiediet sarkano ĀRKĀRTAS APTURĒŠANAS pogu **(19. fotoattēls)**.

Lai atkārtoti aktivizētu vannas pacēlāju, vēlreiz nospiediet zaļo jaudas/ieslēgšanas pogu. Ja netiek nospiesta neviena poga, manuālā vadība automātiski izslēdzas pēc 30 minūtēm. Ja vēlaties pats izslēgt vannas pacēlāju, nospiediet manuālās vadības pults sarkano pogu (indikatora gaisma nodziest).

- Poga “uz leju” (zila)
- ĀRKĀRTAS APTURĒŠANAS poga (sarkana)
- Indikators (LED)
- Poga “uz augšu” (dzeltena)
- Jaudas/ieslēgšanas poga (zaļa)

Darbība mazgāšanās laikā

1. Pirms vannas pacēlāja pirmās ekspluatācijas reizes pārliecinieties, vai manuālās vadības pults ir pareizi pievienota vannas pacēlājam, izmantojot spraudsavienojumu. Tas ir pareizi pievienots, kad sarkanais gredzens uz ligzdas vairs nav redzams **(20. fotoattēls)**.

2. Nospiediet jaudas/ieslēgšanas pogu (zaļā krāsā) uz manuālās vadības pults. Tagad indikators deg zaļā krāsā.

3. Tagad nospiediet pogu “uz augšu” (dzeltenā krāsā). Atzveltne sākotnēji pagriežas vertikālā stāvoklī. Pēc tam pacēlājs virzās uz augšu līdz galējam stāvoklim un automātiski izslēdzas. Ja poga tiek atlaista, pacēlājs apstājas, lai būtu iespējamas arī starppozīcijas.

4. Atlociet sānu atlokus, līdz tie atrodas uz vannas malas. Paceliet sēdekli tikai līdz līmenim, kurā sēdekļa virsma ir vienā augstumā ar vannas malu, un sānu atloki veido horizontālu virsmu.

Svarīgi: sānu atlokiem līdzeni jāatrodas uz vannas malas.

5. Nosēdiniet vannojamo personu uz vannas pacēlāja.

6. Lai nolaistu vannas pacēlāju, nospiediet pogu “uz leju” (zilā krāsā). Pacēlājs vispirms virzās uz leju līdz gala stāvoklim. Pēc tam atzveltne automātiski atgāžas atpakaļ.

Gala stāvoklī barošanas bloks automātiski izslēdzas. Ja poga tiek atlaista, pacēlājs apstājas, lai būtu iespējamas arī starppozīcijas.

Svarīgi! Kad atzveltne pieskaras vannas aizmugurējai sienai, nekavējoties atlaidiet zilo pogu.

7. Kad mazgāšanās ir pabeigta, nospiediet manuālās vadības pults pogu “uz augšu” (dzeltenā krāsā), lai paceltu pacēlāju atpakaļ pareizajā augstumā (maksimālais augšējais gala punkts). **Nodrošiniet, lai sānu atloki neaizķertos uz esošajiem vannas rokturiem.**

8. Palīdziet personai izkāpt pār vannas malu.

Ja manuālā vadība netiek izmantota 30 minūtes, tā automātiski izslēdzas. Ja vēlaties pats izslēgt vannas pacēlāju, nospiediet manuālās vadības pults sarkano pogu (indikatora gaisma nodziest).

Piezīme:

Paceļot un nolaižot pacēlāju, atbalstieties pret atzveltni un rokas ielieciet klēpī.

Ja pacēlājs paliek vannā, manuālā vadība ar integrēto akumulatoru ir jāatvieno un jāuzlādē. Tas novērš nejaušu akumulatora iztukšošanos.

Pacēlāja izņemšana no vannas

Vispirms izmantojiet manuālo vadību, lai pilnībā nolaistu vannas pacēlāju un ļaujiet atzveltnei atgāzties līdz galam, līdz barošanas bloks pats apstājas savā gala pozīcijā **(21. fotoattēls)**. To darot, nodrošiniet, lai atzveltne neatsistos pret vannas sienu. Pēc tam atvienojiet manuālo vadību.

1. Nolokiet sēdekļa virsmas sānu atlokus uz iekšu.
2. Nolokiet atzveltni uz priekšu. Lai noturētu pacēlāju, izmantojiet piedziņas bloka rokturus.

3. Jānodrošina, lai pacelšanas stienis vienmēr būtu pilnībā ievilkts **(23. fotoattēls)**.

Nepareizi

Pareizi

2. Tagad piedziņas bloku var noņemt no sēdekļa rāmja bultiņas virzienā.

Piezīme: Piedziņas bloku var noņemt tikai noteiktā leņķī. Tādēļ to vairs nevar noņemt no sēdekļa bloka, kad tas ir pilnībā nolocīts uz priekšu, jo pēc tam tas atkal tiek nofiksēts vietā. Novietojiet atzveltni leņķī, kā parādīts 24. fotoattēlā, un pēc tam noņemiet piedziņas bloku no sēdekļa rāmja bultiņas virzienā.

4. Atbrīvojiet abus aizmugurējos piesūcekņus uz pamatplāksnes, pavelkot tos aiz vadiņiem. Pēc tam paceliet pamatplāksni atpakaļ, kā rezultātā priekšējie piesūcekņi automātiski atgaisosies un atvienosies. Tagad izņemiet sēdekļa bloku no vannas.

Uzturēšana un apkope

Vannas pacēlāja apkope

Vannas pacēlājs ir aprīkots ar gultņiem un gultņu virsmām, kurām nav nepieciešama apkope. Tādēļ eļļošana nav nepieciešama.

Viss vannas pacēlājs ir periodiski jāpārbauda (vizuāla pārbaude, ko veic lietotājs) vismaz reizi 6 mēnešos. Tas ietver vizuālu pārbaudi, jo īpaši nesošo daļu un drošības elementu, kā arī visu nepieciešamo funkciju pārbaudi.

Ja tiek atklāti defekti, nodilums vai citi bojājumi, kas apdraud pacēlāja drošību, vannas pacēlājs ir jāizņem no ekspluatācijas un trūkumi jānovērš. Remontdarbi jāveic atbilstošām un attiecīgi kvalificētām personām, kuras var pienācīgi veikt šāda veida remontdarbus, pamatojoties uz savu apmācību, zināšanām un praktiskā darbā gūto pieredzi.

Remontu drīkst veikt tikai pilnvarotais izplatītājs.

Uzmanību: Manuālās vadības pulti drīkst atvērt tikai vannas pacēlāja ražotājs!

Tīrīšana

Pacēlājs ir jātīra uzreiz pēc lietošanas (vēlams, noskalojot ar karstu ūdeni), lai vannas pacēlājs būtu optimālā stāvoklī. Vannas pacēlājs rūpīgi jānoskalo pēc katras mazgāšanās reizes. Vannas pacēlāja tīrīšanai (bez pārsegiem) izmantojiet sadzīves tīrīšanas līdzekļus bez abrazīvām vielām, kā arī tirdzniecībā pieejamos dezinfekcijas līdzekļus.

Pārvalku kopšana

Noņemamo pārvalku materiāls ir higiēnisks to gludās virsmas un antibakteriālo īpašību dēļ.

Pārvalku kopšanai nepieciešama regulāra mazgāšana ar rokām vai veļas mašīnā 60°C temperatūrā. Izmantojiet nebioloģisku mazgāšanas līdzekli bez fermentiem. Ņemiet vērā, ka vannas piedevas, kas satur eļļu, ko lietojat vannošanās laikā, var notraipīt pārvalkus. Regulāri nemazgājot pārvalkus, tie var arī mainīt krāsu.

Piezīme: Garantija neattiecas uz pārvalku krāsas maiņu vai izbalošanu, jo pārvalki ir nolietojamas sastāvdaļas.

- Pārvalkus var viegli noņemt tīrīšanai.
- Nežāvējiet pārvalkus žāvētājā; tā vietā tie ir jāizkar, lai izžūtu.
- Papildus ieteicams izmantot tirdzniecībā pieejamu dezinfekcijas līdzekli.
- Ievērojiet ražotāja norādījumus!

Vannas pacēlāja pārsega jaunu spilvenu aizbāžņu montāža

Vispirms no augšas caur caurumu spilvenā izveriet jauno aizbāzni, pēc tam uzspiediet uz diska apakšu, lai nostiprinātu **(25. -26. fotoattēls)**.

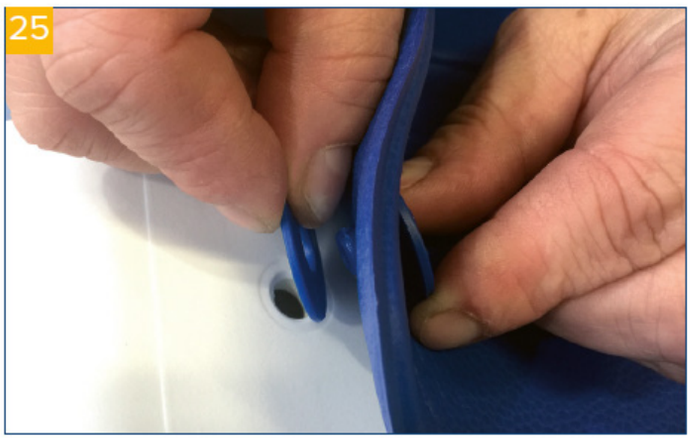

Uzturēšana un apkope

Barošanas bloka apkope
Barošanas blokam nav nepieciešama apkope. Korpusu drīkst tīrīt tikai ar šķīdinātājus nesaturošiem tīrīšanas līdzekļiem vai nedaudz samitrinātu drānu. To darot, nodrošiniet, lai barošanas blokā neiekļūtu mitrums. Pirms atkārtotas iedarbināšanas ir jāpārliecinās, vai barošanas bloks ir pilnībā izžuvis. Ja nepieciešams, barošanas bloks vairākas stundas jānovieto sausā, vēdināmā vietā bez barošanas avota.

Uzmanību:
Pirms tīrīšanas barošanas bloks ir pilnībā jāatvieno no elektrotīkla, atvienojot to no kontaktligzdas.

Akumulatora uzlāde
Pirms katras lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Informācijai par spriegumu uz barošanas bloka ir jāatbilst jūsu barošanas avota spriegumam.

1. Ievietojiet barošanas bloka dakšu ligzdā uz manuālās vadības pults spirālveida vada, līdz pacēlājs ar klikšķi nofiksējas vietā.

2. Pieslēdziet barošanas bloku kontaktligzdai.

3. Manuālās vadības pults sarkanais indikators deg sarkanā krāsā, līdz akumulators ir uzlādēts. Kad tas ir uzlādēts, tas deg zaļā krāsā. Ja akumulators ir pilnībā jāuzlādē, atstājiet akumulatoru pievienotu barošanas blokam. Barošanas bloka vadības sistēma beidz uzlādes procesu pēc apm. 4 stundām. Tas novērš pārmērīgu akumulatora uzlādi.

4. Atvienojiet barošanas bloku no kontaktligzdas.

5. Izvelciet barošanas bloka dakšu no manuālās vadības ierīces ligzdas.

Svarīga informācija:
Ja uzlādes indikators neiedegas pēc manuālās vadības ierīces pievienošanas, pārbaudiet šādus punktus:

• Savienojumu kvalitāte (dakša pilnībā ievietota uzlādes kontaktligzdā).

• Pārbaudiet, vai manuālās vadības pults, spirālveida vads ar kontaktligzdu un uzlādes vads nav bojāti.

Piezīme:
Ja barošanas bloks ir bojāts, nododiet to piegādātājam pārbaudei.

Transportēšana / Mobilā lietošana

Ja pārvadājat pacēlāju uz dažādām vietām, papildus jāpatur prātā:

1. Vannas pacēlāja manuālās vadības pults ir jāatvieno no elektrotīkla un jātransportē atsevišķi.

2. Transportēšanas laikā (piemēram, transportlīdzeklī) vienmēr nostipriniet vannas pacēlāju, nodrošinoties pret slīdēšanu.

3. Ja manuālās vadības pultī iebūvētais akumulators ir pakļauts zemai temperatūrai (piemēram, ziemā, glabājot transportlīdzeklī), ļaujiet akumulatoram sasilt līdz istabas temperatūrai un, ja nepieciešams, uzlādējiet.

4. Paceļot, ievērojiet produkta svaru: sēdekļa bloks sver apm. 5,5 kg un piedziņas bloks (bez manuālās vadības pults) sver apm. 3,8 kg.

Transportēšana izjauktā stāvoklī atsevišķi pa daļām.
Sēdekli un piedziņas bloku var viegli pārnēsāt abās rokās.

Transportēšana slēgtā stāvoklī
Vannas pacēlāju var transportēt arī kā neizjauktu vienību.

Tehniskie dati	
Kopējais garums	830 mm
Kopējais platums	700 mm
Sēdekļa platums	380 mm
Sēdekļa dziļums	420 mm
Sēdekļa virsmas kopējais garums	570 mm
Sēdekļa augstums, min.	65 mm
Sēdekļa augstums, maks.	480 mm
Atzveltnes augstums	640 mm
Atzveltnes platums	320 - 360 mm
Atzveltnes regulēšana	10° - 50°
Pamatnes plāksnes platums	310 mm
Pamatnes plāksnes garums	560 mm
Maks. slodze	140 kg
Kopējais svars bez manuālās vadības pults	9.3 kg
Kopējais svars t.sk. manuālās vadības pults	9.7 kg

Darbības vides apstākļi	
Temperatūra	+10° - +50°
Relatīvais gaisa mitrums	10 ..... 100%
Gaisa spiediens	700 hPa ..... 1060 hPa

Vides nosacījumi transportēšanai un uzglabāšanai	
Temperatūra	–10°C .....+40°C
Relatīvais gaisa mitrums	10 ..... 100%
Gaisa spiediens	700 hPa ..... 1060 hPa

Utilizēšana

Ja prece jums vairs nav vajadzīga, lūdzu, sazinieties ar specializēto izplatītāju vai nogādājiet preci vietējā atkritumu savākšanas centrā.

Veco iekārtu un iepakojuma iznīcināšanai un pārstrādei jānotiek saskaņā ar juridiski piemērojamiem noteikumiem. Ierīces, uz kurām attiecas Elektrisko un elektronisko iekārtu likums (ElektroG), ir iekļautas fondā “Elektro-Altgeräte-Register” [veco elektrisko un elektronisko iekārtu valsts reģistrs] kā medicīnas ierīces profesionāliem lietotājiem - B2B.

Mūsu reģistrācijas numurs ir: DE 33275322

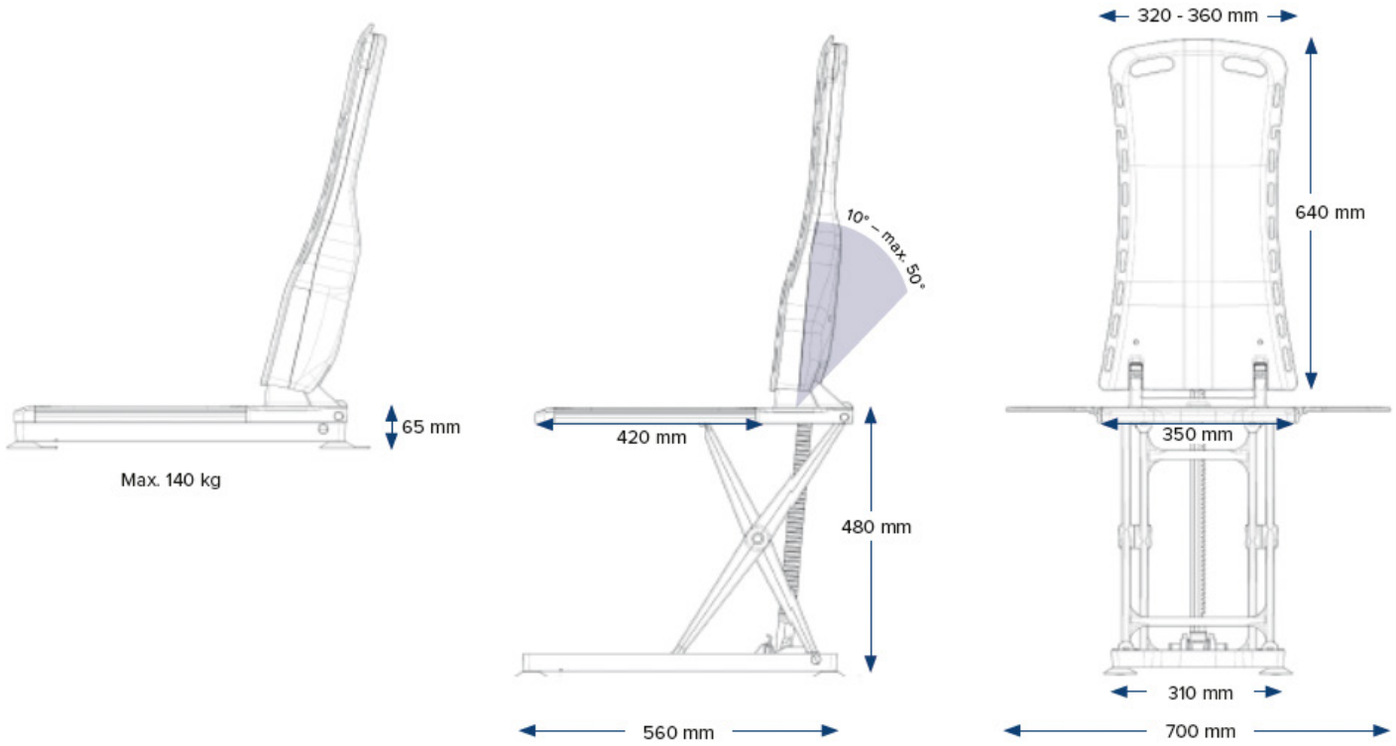

Your specialist dealer:

Subject to error and change
Last updated: 06.10.2020
Version: MDR-1.0

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu • Germany
T +49 7562 9724 0 • **F** +49 7562 9724 25
www.drivemedical.de • info@drivemedical.de